



RENDEZVÉNYNAPTÁR

Megnevezés	Időpont / helyszín	Rendező
A Codex Alimentarius Mintavételi és Analitikai Módszerek Bizottságának ülése	1997. március 10-14. Budapest	KÉKI Fax: 1558-991
A Magyar Élelmiszerkönyv cukorfélékre vonatkozó előírásai	1997. április 17. Budapest	EOQ MNB Fax: 274-1005
Kihelyezett érzékszervi tanfolyam és alkalmasságvizsgálat a Döhler-Szilas Kft.-nél	1997. április 15-18. Kerepestarcsa	EOQ MNB / KÉKI Fax: 274-1005
„A minőségjavítás és -biztosítás aktuális feladatai az agrárgazdaságban” Konferencia	1997. április 24. Budapest	EOQ MNB, Fax: 274-1005 Magyar Élelmiszerminősítő Társaság, Fax: 1294411
XVII. Országos Minőségügyi Konferencia	1997. május 21. Budapest	EOQ MNB / MTESZ Fax: 274-1005
„Bioavailability '97” Konferencia	1997. május 25-28. Wageningen/Hollandia	Mrs. L. Duym Fax: 00/31/317/483342
„Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésére alkalmas élelmiszerek előállítására és forgalmazására” témájú Világbanki Projekt indító Konferenciája	1997. május 27-28. Budapest	KÉKI Fax: 1558-991
Az EOQ MNB 1997. évi közgyűlése	1997. június 5. Budapest	EOQ MNB Fax: 274-1005
41. EOQ Kongresszus	1997. június 16-20. Trondheim/Norvégia	EOQ MNB Fax: 274-1005
VIII. Európai Biotechnológiai Kongresszus	1997. augusztus 18-22. Budapest	Prof. Nyeste László Fax: 463-2598
EURO FOOD CHEM IX.	1997. szeptember 24-26. Interlaken/Svájc	Dr. Reto Battaglia Fax: 00/41/1/2773170
Beszámoló a 41. EOQ Kongresszusról	1997. szeptember 30. Budapest	EOQ MNB Fax: 274-1005
Az új Élelmiszertörvény végrehajtásának tapasztalatai, valamint tájékoztató a „SZÍV” Projekt termékeinek jóváhagyásáról és jelöléséről	1997. október 15. Budapest	EOQ MNB / KÉKI Fax: 274-1005
„Európai Minőség Hét Magyarországon, 1997” keretén belül Nemzetközi Élelmiszerminőségügyi Konferencia	1997. november 10-14. Budapest	EOQ MNB / Magyar Élelmiszerminősítő Társaság Fax: 274-1005
Minőségügyi tanácsadók, tanúsítók és tanúsítottak regionális találkozója Szakágazati minőségügyi rendezvények		



TOC 1200

- Katalizátor-mentes rendszer
- Magas hőmérsékletű kemence
- NDIR detektor
- TC, IC, TOC, POC, NPOC
- 50 ppb - 4000 ppm
- 3 perces analízis idő
- Szilárd és folyékony minták elemzése
- Automata mintaváltó opciója

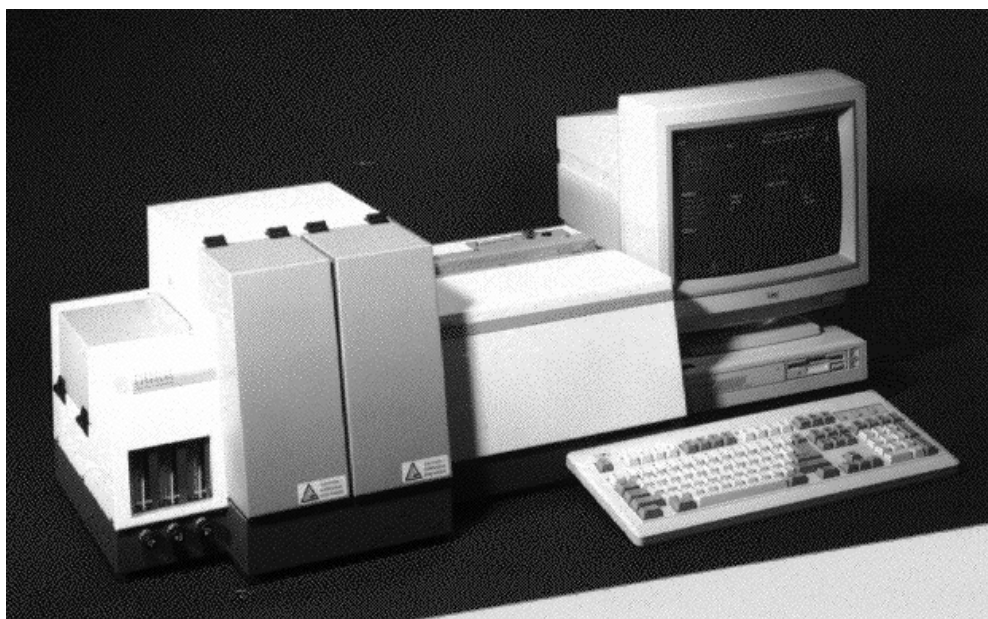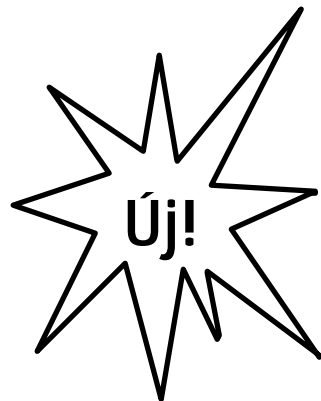

Kizárólagos képviselet:

UNICAM Magyarország Kft.
1148 Budapest, Lengyel u. 19.
Tel: 383 4569 ♦ Fax: 221 9051
